



Una nuova norma di progettazione per i connettori dei sondini per i dispositivi medici è in corso di elaborazione. A partire dalla nutrizione enterale, le norme specifiche di applicazione aiuteranno a garantire che i connettori non si colleghino ad attacchi che non siano quelli previsti, al fine di ridurre l'insorgenza di collegamenti errati.

Questa iniziativa globale per la sicurezza dei pazienti è stata avviata negli USA, in Canada e a Porto Rico, con l'obiettivo di essere completata in questi mercati entro il 2016.


Più di chiunque altro, personale sanitario e medici dovranno trattare e utilizzare i nuovi connettori ENFit, per cui la vostra preparazione è fondamentale. Il presente non intende essere un elenco completo, tuttavia vi consigliamo di utilizzare la procedura sotto riportata per iniziare:

S	Comunicazione con i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prendete dimestichezza con tutti i cambiamenti specifici di questi prodotti <input type="checkbox"/> Provate i nuovi connettori con tutti i prodotti, compresi i kit di alimentazione, le siringhe per uso enterale e i cateteri <input type="checkbox"/> Siate consapevoli del valore della preparazione anticipata alla transizione
T	Training	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Coinvolgete il vostro team di formazione all'assistenza <input type="checkbox"/> Comunicate l'importanza delle modifiche al connettore per migliorare la sicurezza dei pazienti <input type="checkbox"/> Spiegate come i nuovi kit di alimentazione cambieranno e dimostrate come vanno collegati <input type="checkbox"/> Sottolineate il dispositivo di blocco e i vantaggi in termini di sicurezza del nuovo connettore ENFit <input type="checkbox"/> Identificate un utente ideale per ciascun turno e cercate opportunità di pratica
E	Formazione	<p>Paziente/Assistente</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Discutete le implicazioni delle imminenti modifiche dei connettori, compresa la tempistica e il processo di transizione <input type="checkbox"/> Pianificate opportunità per i pazienti/assistenti che vanno a casa e devono seguire un'alimentazione enterale per imparare: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La differenza tra dispositivi attuali e nuovi e come funzionano <input type="checkbox"/> La somministrazione di preparati e farmaci enterali se prescritti <input type="checkbox"/> A risciacquare il catetere e verificare eventuali residui <input type="checkbox"/> Fornire ulteriore idratazione <input type="checkbox"/> Fornite la lista di controllo ai pazienti/assistenti dimessi con alimentazione enterale <p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presentate domande relative al prodotto specifico al produttore/fornitore <input type="checkbox"/> Presentate domande sulla procedura ad un team di transizione multidisciplinare
P	Processo	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Costituite un team di transizione multidisciplinare per valutare le attuali procedure e protocolli e rettificateli per includere i nuovi connettori ENFit <input type="checkbox"/> Aggiornate i kit enterali e di ordini di consegna di medicinali per l'utilizzo dei nuovi prodotti <input type="checkbox"/> Rivedete i processi di preparazione medico-farmaceutica e di consegna per prendere in considerazione le nuove siringhe per uso specifico enterale <input type="checkbox"/> Sviluppate meccanismi di comunicazione tra personale sanitario e farmacia al fine di identificare i pazienti che necessitano di farmaci somministrati tramite catetere <input type="checkbox"/> Informate medici e farmacisti che gli ordinativi di farmaci devono specificare il percorso: enterale (catetere) oppure orale (per bocca) e non dire "po" in entrambi i casi. Fino a quando non sarà terminata la transizione dei connettori ENFit, gli ordini devono indicare anche quale connettore il paziente sta utilizzando
S	Gestione fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rivedete e consolidate tutte le aree magazzino per i dispositivi enterali (kit di alimentazione, siringhe specifiche per uso enterale, sondini) in preparazione di un nuovo inventario <input type="checkbox"/> Riducete gli stock in eccesso di dispositivi enterali con gli attuali connettori <input type="checkbox"/> Fate avanzare il flusso di magazzino dei sondini e dei connettori di transizione ENFit <input type="checkbox"/> Evitate scorte eccessive di ogni prodotto per l'alimentazione enterale

Modifiche al connettore sistema enterale


La nuova norma di progettazione riguarda l'intero sistema di nutrizione enterale

ESTREMITÀ LATO CONTENITORE




CONNETTORE (DEFINITIVO)
[Dal 2012]


ESTREMITÀ LATO PAZIENTE




SIRINGA (ATTUALE)




SIRINGA (DEFINITIVA)
Le siringhe per la somministrazione di medicinali, il risciacquo, l'idratazione o la somministrazione in bolo tramite catetere richiederanno ora uno specifico sistema di connessione.



CATETERE (ATTUALE)

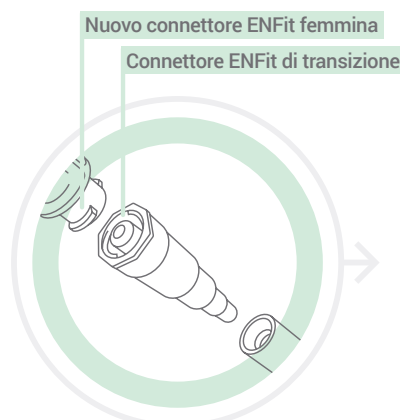

KIT DI TRANSIZIONE (TEMPORANEO)
Può essere collegato all'attacco di nutrizione fino a quando non saranno disponibili i nuovi sondini enterali ENFit.



CATETERE (DEFINITIVO)
Passaggio dal connettore maschio (scalare o ad albero) al nuovo connettore femmina ENFit. L'attacco del catetere per il kit di somministrazione cambierà da femmina a maschio.



A.S.P.E.N. www.nutritioncare.org



AACN www.aacn.org



SGNA www.sgna.org

Per maggiori informazioni e per ricevere aggiornamenti tramite email, visitate StayConnected2014.org.

v.1 ©2014 G&DSA