Prepare-se para o novo conector ENFit®!

Lista de verificação para a transição - Instalações e instituições

As novas normas de projeto para conectores de tubos de dispositivos médicos já estão em vigor. Começando pela alimentação enteral, as normas específicas para cada aplicação ajudarão a garantir que os conectores não se encaixem em portas diferentes daquelas para as quais foram projetados, o que reduzirá o risco de conexões incorretas.

Cada organização tem um processo diferente para implementar mudanças, mas todas exigem uma equipe multifuncional bem informada e devidamente preparada. Use os seguintes PASSOS como guia de discussão para sua equipe de transição.

Os hospitais, centros de cuidados de longa duração e outras instituições devem compreender bem as mudanças e ser capazes de divulgar essas informações entre os diferentes grupos da organização. Esta lista não pretende ser exaustiva, mas utilize os PASSOS indicados a seguir para ajudar sua organização a se preparar para as mudanças iminentes:

P	**Comunicação com os fornecedores**	☐ Familiarizar-se com todos os componentes que compõem um sistema de alimentação enteral (incluindo kits de alimentação, seringas específicas para alimentação enteral e sondas de alimentação) e o cronograma de transição correspondente
A	**Treinamento**	☐ Certifique-se de que todos os departamentos estejam a par da situação e preparados para a transição por meio da comunicação com a direção, da organização de palestras e seminários, da distribuição de listas de verificação específicas para cada departamento e do uso de outras ferramentas de comunicação utilizadas pela sua organização
SS	**Educação**	☐ Lembre-se de que essa mudança afeta várias funções dentro da sua organização ☐ **Diretor médico:** avaliar as mudanças necessárias nas práticas de prescrição, colocação de sondas ou documentação. ☐ **Equipe clínica:** enfermeiros, médicos, nutricionistas clínicos e outros profissionais de saúde de todas as áreas de atendimento ao paciente nas quais sejam colocadas ou utilizadas sondas de alimentação devem saber quais produtos serão afetados, como funcionam os novos conectores e quando ocorrerá a mudança ☐ **Farmácia:** planejar o armazenamento dos novos produtos e as mudanças nos protocolos e processos. p Cadeia de suprimentos e gestão de materiais: compreender os prazos da transição e planejar o espaço de armazenamento no depósito central, nas unidades de enfermagem e nas enfermarias. ☐ **TI/Informática:** definir um plano caso seja necessário modificar os conjuntos de prescrições médicas. ☐ **Responsáveis pela gestão de riscos e segurança do paciente: c**ompreender o impacto de todas as mudanças para ajudar a mitigar quaisquer problemas.
O	**Processo**	☐ Criar uma equipe multidisciplinar que abranja toda a instituição para auxiliar nas fases de preparação, treinamento e implementação dessa mudança que afeta todo o sistema de alimentação enteral
S	**Gestão do abastecimento**	☐ Manter um estoque adequado, sem excesso de estoque, devoluções ou desperdício desnecessário

A ENFit® é uma marca registrada federalmente pela GEDSA em várias jurisdições em todo o mundo.

Alterações no conector do sistema de alimentação enteral ENFit

A nova norma de projeto abrange todo o sistema de alimentação enteral

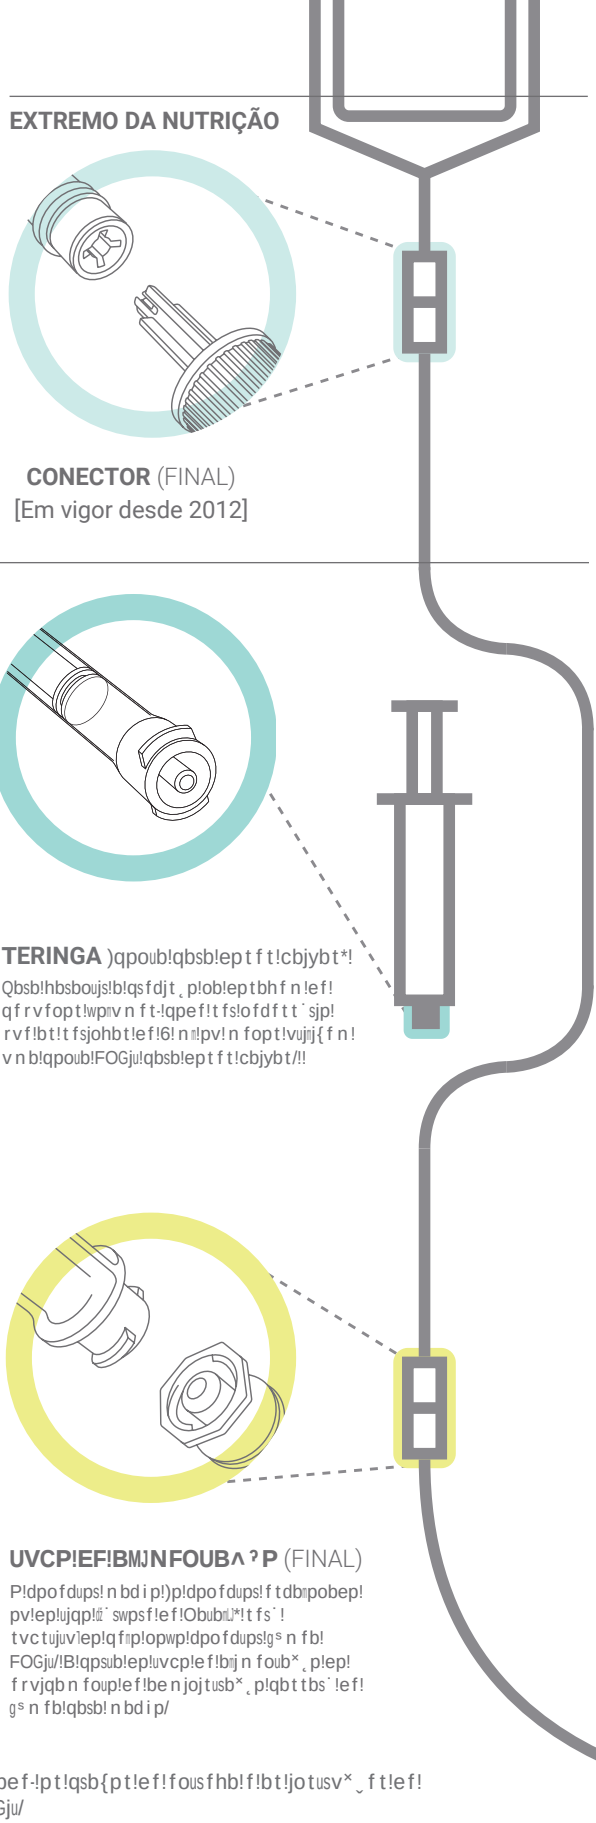

EXTREMO DA NUTRIÇÃO

CONECTOR (FINAL)
[Em vigor desde 2012]

EXTREMO DE ACESSO DO PACIENTE

TFSJOHBI(ATUAL)

TERINGA (Qpoub!qbes˛p)

Bt!tfsjohbt!eftujobebt!˘!benjojtusb^˛p!ef!
nîrvjept-!nfjdbn foupt-!sfbnj{b^˛p!ef!mbwbhfot!
pv!benjojtusb^˛p!ef!bnjn foub^˛p!fn!cpnvt!qps!
tpoebt!fou!sjdbt!efwfs˛p!bhpsb!qpttvjs!vn!
bdfttɹsjp!ftqfdîgjdp!qbsb!vtp!fou!sjdp/!!

OU

TERINGA)qpoub!qbsb!eptfft!cbjybt*!

Qbsb!hbsboujs!b!qsfdjt˛p!ob!eptbhfn!ef!
qfrvfopt!wpnvnft-!qpef!tfs!ofdfttˋsjp!
rvf!bt!tfsjohbt!ef!6!nî!pv!n fopt!vujnj{fn!
vnb!qpoub!FOGju!qbsb!eptfft!cbjybt/!!

Opwp!dpofdups!gsn fb!FOGju

Dpofdups!ef!usbotj^˛p!FOGju

UVCP!EF!BMJNFOUB^?P!(ATUAL)

LJU!EF!USBOTJ^?P!
(UFNQPSˇSJP)

Qfsnjuf!b!jotubnb^˛p!op!dbufufs!
ef!bnjn foub^˛p!buvbn!bu!!rvf!bt!
opwbt!tpoebt!ef!bnjn foub^˛p!
foufsbn!FOGju!ftufkbn!
ejtqpoîwfjt/

UVCP!EF!BMJNFOUB^?P (FINAL)

P!dpofdups!nbdip!)p!dpofdups!ftdbnpobep!
pv!ep!ujqp!tîˇswpsf!ef!ObubM^*!tfsˇ!
tvctujuvîep!qfnp!opwp!dpofdups!gsn fb!
FOGju/!B!qpsub!ep!uvcp!ef!bnjn foub^˛p!ep!
frvjqbn foup!ef!benjojtusb^˛p!qbttbsˇ!ef!
gsn fb!qbsb!nbdip/

Pctfswb^˛p: Dpotvmuf!pt!sfqsftfoubouft!ep!tfv!gpsofdfeps!tpcsf!b!ejtqpojcjmjebef-!pt!qsb{pt!ef!fousfhb!f!bt!jotusv^˛ft!ef!
vtp!ept!frvjqbn foupt!ef!benjojtusb^˛p-!tfsjohbt!f!tpoebt!ef!bnjn foub^˛p!FOGju/

Qbsb!nbjt!jogpsnb^˛ft-!bdfttf: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026GEDSA