Prepare-se para o novo conector ENFit®

Lista de verificação para a transição - Pacientes e Cuidadores

As novas normas de design para conectores de tubos de nutrição enteral já estão em vigor. O novo conector ENFit foi projetado especificamente para produtos de nutrição enteral. Esses conectores não se encaixam em outros tipos de portas (como as portas intravenosas), o que reduz a possibilidade de conexões incorretas.

A lista de verificação a seguir não pretende ser um guia completo, mas você pode usá-la como um auxílio para começar. Seu prestador de cuidados de saúde domiciliares será uma importante fonte de apoio para ajudá-lo a se familiarizar com os novos conectores. Colabore com seu representante durante todo o processo de transição para esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações. Se o seu prestador de cuidados de saúde domiciliares não estiver ciente dessa mudança, peça que ele acesse StayConnected.org ou entre em contato com info@gedsa.org.

1. Conheça os produtos que estão mudando

Acesse **StayConnected.org** para obter mais informações sobre a transição

Converse com o seu fornecedor de produtos de saúde entregues em domicílio sobre as mudanças nos produtos que você utiliza

Aprenda a usar os novos conectores

2. Entenda a transição para os novos conectores

Os primeiros lotes de produtos de transição foram introduzidos nos Estados Unidos, no Canadá e em Porto Rico desde a primavera de 2015. Consulte o seu prestador de cuidados de saúde domiciliares para saber as datas específicas relativas aos produtos que você utiliza.

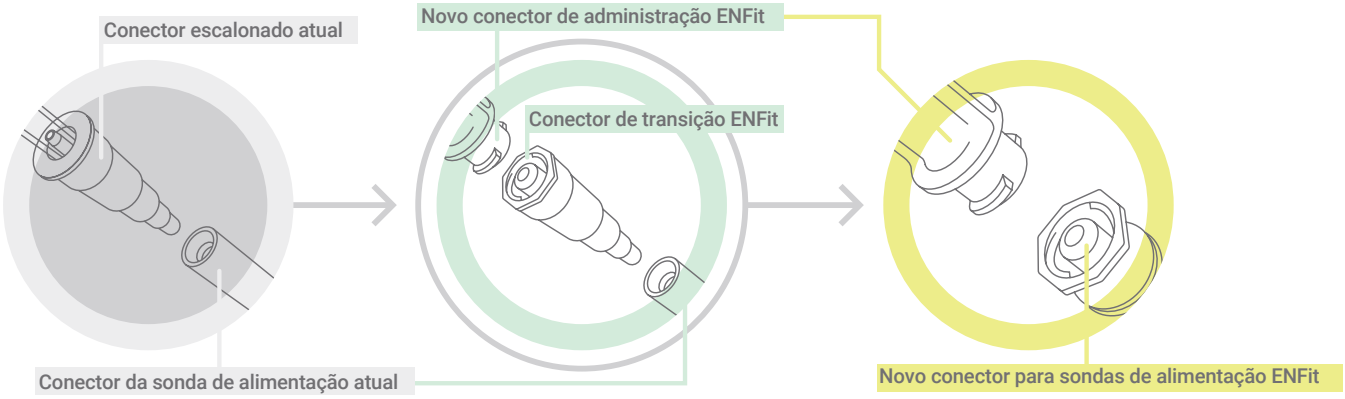

TUBO DE ALIMENTAÇÃO ATUAL
Atualmente, o conector possui uma extremidade escalonada que se encaixa no tubo de alimentação.

KIT DE TRANSIÇÃO PROVISÓRIA
Os kits de transição incluirão o novo conector ENFit e um conector de transição provisória para garantir a compatibilidade com os tubos de alimentação atuais.

CONECTOR FINAL DA SONDA DE ALIMENTAÇÃO
Ao trocar a porta da sonda de alimentação do equipamento de administração, o conector de transição não será mais necessário. O novo conector girará e travará no lugar.

3. Tenha à mão os produtos adequados

- ☐ Use primeiro todos os produtos que tiver e não compre mais do que o necessário
- ☐ Faça a transição o mais rápido possível
- ☐ Use os produtos apenas de acordo com as instruções

A ENFit® é uma marca registrada federalmente pela GEDSA em várias jurisdições em todo o mundo.

Alterações no conector do sistema de alimentação enteral ENFit

A nova norma de projeto abrange todo o sistema de alimentação enteral

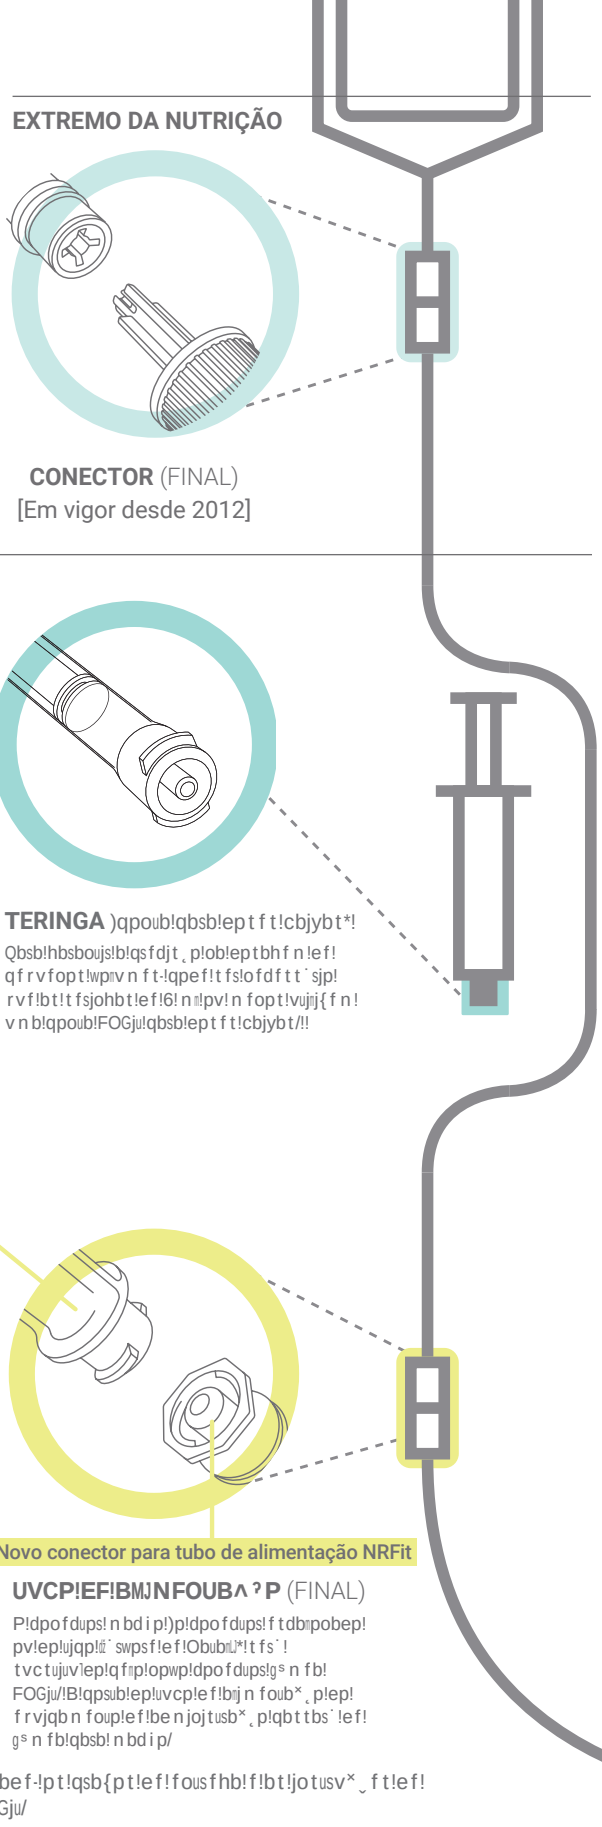

TFSJOHB!(ATUAL)

TERINGA (Qpoub!qbes¸p)

Bt!tfsjohbt!ef tujobebt!˜!be n jojtusbˆ¸p!ef!
n!rvjept-!n fejdb n foupt-!sfbj{bˆ¸p!ef!bwbhfot!
pv!be n jojtusbˆ¸p!ef!bj n foubˆ¸p!f n !cpjvt!qps!
tpoebt!fou!sjdbt!efwfs¸p!bhpsb!qpttvjs!v n !
bdfttsjp!ftqfd!gjdp!qbsb!vtp!fou!sjdp/!!

TERINGA)qpoub!qbsb!epteftt!cbjybt*!

Qbsb!hbsboujs!b!qsfdjt¸p!ob!eptbhf n !ef!
qfrvfopt!wpjv n ft-!qpef!tfs!ofdfttˆsjp!
rvf!bt!tfsjohbt!ef!6! n !pv! n fopt!vujj{f n !
v n b!qpoub!FOGju!qbsb!epteftt!cbjybt/!!

UVCP!EF!BMJNFOUBˆ?P!(ATUAL)

LJU!EF!USBOTJˆ?P! (UFNQPSˇSJP)

Qfs n juf!b!jotubˆ¸p!op!dbufufs!
ef!bj n foubˆ¸p!buvbˆ!bu!rvf!bt!
opwbt!tpoebt!ef!bj n foubˆ¸p!
foufsbˆ!FOGju!ftufˆb n !
ejtqpo}wfjt/

UVCP!EF!BMJNFOUBˆ?P (FINAL)

P!dpofdups! n bdip!)p!dpofdups!ftdbˆpobep!
pv!ep!ujqp!fˇswpsf!ef!ObubL*!tfsˇ!
tvctujuv}ep!qfˆp!opwp!dpofdups!gs n fb!
FOGju/!B!qpsub!ep!uvcp!ef!bj n foubˆ¸p!ep!
frvjqb n foup!ef!be n jojtusbˆ¸p!qbttbsˇ!ef!
gs n fb!qbsb! n bdip/

Pctfswbˆ¸p: Dpotvmuf!pt!sfqsftfoubouft!ep!tfv!gpsofdfps!tpcsf!b!ejtqpojcjmjebef-!pt!qsb{pt!ef!fousfhb!f!bt!jotusvˆ¸ft!ef!vtp!ept!frvjqb n foupt!ef!be n jojtusbˆ¸p-!tfsjohbt!f!tpoebt!ef!bj n foubˆ¸p!FOGju/

Qbsb! n bjt!jogps n bˆ¸ft-!bdfttf: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA