Prepárese para el nuevo conector ENFit®

Lista de verificación para la transición - Personal de Cadena de Suministros

Se han establecido nuevas normas de diseño para los conectores de pequeño diámetro utilizados en los tubos de los dispositivos médicos, incluidos los nuevos conectores para dispositivos de alimentación enteral, neuroaxiales y respiratorios. Empezando por la alimentación enteral y el nuevo conector ENFit ISO 80369-3, las normas específicas para cada aplicación contribuirán a garantizar que los conectores no encajen en puertos distintos del tipo para el que están destinados, lo que reducirá el riesgo de conexiones erróneas.

Cada organización tiene un proceso diferente para implementar el cambio, pero todas requieren un equipo multifuncional bien informado y debidamente preparado. Utilice los siguientes PASOS como guía de debate para su equipo de transición.

Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sigue los PASOS que se indican a continuación para empezar:

P — Comunicación con los proveedores

- ☐ Familiarícese con todos los cambios específicos de cada producto
- ☐ Conozca los plazos previstos y la disponibilidad de los productos durante la transición
- ☐ Obtenga los cambios en los números de referencia, junto con una tabla de correspondencias entre los productos con los conectores actuales y los nuevos conectores ENFit
- ☐ Aclare las políticas de devolución durante la transición

A — Entrenamiento

- ☐ Establecer un calendario para la disponibilidad de los productos en las instalaciones y los canales de comunicación
- ☐ Reducir el exceso de existencias y desalentar el acaparamiento de productos existentes para evitar:
  - ☐ retraso en la transición
  - ☐ imposibilidad de administrar el tratamiento
  - ☐ aumento de los costes de mantenimiento

S — Educación

- ☐ Comunicar la importancia de los cambios en los conectores para mejorar la seguridad de los pacientes
- ☐ Preparar al personal de la cadena de suministro para que solicite nuevos productos con la conectividad adecuada para:
  - ☐ Kits de administración y alimentación
  - ☐ Sondas de alimentación
  - ☐ Jeringas para alimentación en bolo, comprobación de residuos, administración de medicamentos e hidratación
- ☐ Dirigir las preguntas específicas sobre el producto al fabricante o proveedor
- ☐ Dirigir las preguntas sobre los procedimientos al equipo multidisciplinar de transición

O — Proceso

- ☐ Crear un equipo de transición multidisciplinar que incluya, entre otros, a profesionales clínicos (enfermería, médicos prescriptores, farmacia), personal de la cadena de suministro, de TI, gestores de riesgos, responsables de seguridad del paciente e ingenieros biomédicos
- ☐ Los equipos de transición deben ajustar los procesos para los nuevos conectores ENFit
- ☐ Evaluar los procedimientos actuales y las necesidades de la cadena de suministro durante la transición

S — Gestión del suministro

- ☐ Gestionar el inventario de dispositivos de alimentación enteral para garantizar una conexión adecuada durante toda la transicionn enteral
  - ☐ Reducir el exceso de existencias de dispositivos con conectores actuales
  - ☐ Permitir que los nuevos conectores de transición ENFit y las sondas de alimentación ENFit se incorporen al inventario
  - ☐ Evitar el exceso de existencias de nuevos productos de alimentación enteral

ENFit® es una marca comercial registrada a nivel federal por GEDSA en múltiples jurisdicciones de todo el mundo.

Modificaciones en el conector del sistema enteral ENFit

La nueva norma de diseño afecta a todo el sistema de alimentación enteral

EXTREMO DE NUTRICIÓN



CONECTOR (FINAL)
[En vigor desde 2012]

EXTREMO DE ACCESO DEL PACIENTE

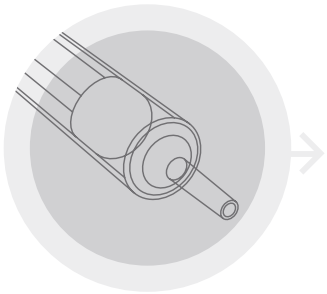

JERINGA (ACTUAL)



O



JERINGA (Punta estándar)
Las jeringas para a administrar hidratar, medicamentos, realizar lavados, o administrar alimentación en bolo por sondas enterales deberán contar ahora con un accesorio específico para uso enteral.

JERINGA (Punta de baja dosificación)
Para garantizar la precisión en la dosificación de pequeños volúmenes, es posible que las jeringas de 5 ml o menos requieran una punta ENFit para dosis bajas.

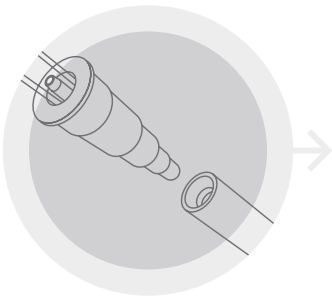

TUBO DE ALIMENTACIÓN (ACTUAL)

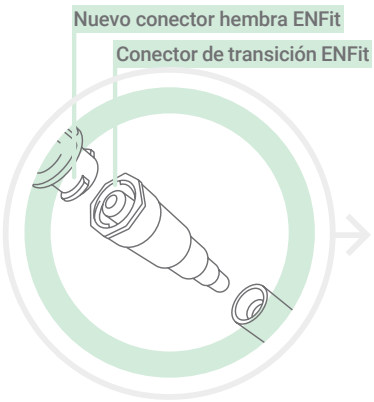

SET PARA TRANSICIÓN (TEMPORAL)
Permite su instalación en el puerto de alimentación actual hasta que estén disponibles las nuevas sondas de alimentación enteral ENFit.

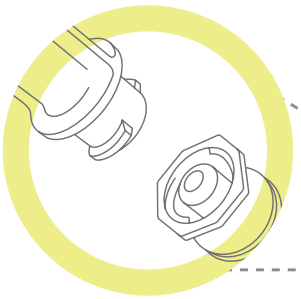

TUBO DE ALIMENTACIÓN (FINAL)
Se cambiará el conector macho (el conector escalonado o tipo "árbol de Navidad") por el nuevo conector hembra ENFit. El puerto del tubo de alimentación para el equipo de administración pasará de ser hembra a macho.

Nota: Consulte a los representantes de su proveedor sobre la disponibilidad, los plazos de entrega y las indicaciones de uso de los equipos de administración, jeringas y sondas de alimentación ENFit.

Para más información, visite: **StayConnected.org**.

v.2 ©2026 GEDSA